



## Bewertungsschreiben Letter of assessment VN635 170861



### Auftrag (Order) VN635 170861.1

#### Antragsteller (Applicant)

Schrack Technik GmbH  
Seybelgasse 13  
1230 Wien  
Austria

#### Kundenreferenz (Reference)

Hr. DI (FH) Martin Reifensteiner

#### Auftrag (Application)

Bewertung einer Schutzmaske nach Durchführung eines verkürzten Bewertungsverfahrens für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA) gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) Rev. 0 vom 20.03.2020" für das Inverkehrbringen in Österreich

*Assessment of a protective mask after implementation of a shortened assessment process for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators (CPA) in accordance with enactment GZ 2020-0.247.451 as well as according to "Test principle for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators Rev. 0 dated 20.03.2020" for placing on the market in Austria*

#### Prüfgut (Test Material)

Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) "GIHCCXM01--"

Das zur Prüfung verwendete Prüfgut wurde für Laboratoriumszwecke anonymisiert. Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

*Material used in testing was anonymized for laboratory purposes. A detailed sample list is contained in the report.*

#### Ausfertigung (Issuing)

Anzahl enthaltener Seiten (Number of pages contained): 8 + gekennzeichnete Anhangsseiten (marked pages of annex) + plombiertes Muster (sealed sample)

Originalausfertigung (Original Issue) / Wien (Vienna) 03.07.2020 / Pf

Dipl.-HTL-Ing. Marion Pfeiler

Stv. Leiterin Zertifizierungsstelle (Deputy Head of Certification Body)

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Notifizierte Stelle NB 0534

(OETI - Institute for Ecology, Technology and Innovation; Notified Body NB 0534)

ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH | Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria  
tel +43 1 5442543-0 | fax +43 1 5442543-10 | email office@oeti.at | FN 326826b | VAT No. ATU65149029  
UniCredit Bank Austria AG | IBAN AT941200023410378800 | BIC BKAUATWW | EORI ATEOS1000015903  
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen | Only our general terms and conditions apply

Member of TESTEX Group

## Inhaltsverzeichnis (index)

1	Auftrag (Order)	2
1.1	Prüfmuster (Samples)	2
1.2	Eingereichte Unterlagen (Informations given by the Customer)	2
2	Bewertungsbericht (Evaluation report)	3
2.1	Allgemein (General)	3
2.2	Anforderungen (Requirements)	4
3	Fotodokumentation (photo documentation)	5
4	Bewertung (assessment)	6
5	Gültigkeit (validity)	7
6	Anmerkungen (Remarks)	8

Anhang zum Bewertungsschreiben bestehend aus

*Annex to the letter of assessment consisting of*

Deckblatt (Cover Sheet) ..... 1 Seite (page)

Technische Dokumentation (Technical Documentation) ..... 6 Seiten (pages)

## 1 Auftrag (Order)

Datum <i>Date</i>	Eingang <i>Received</i>	Auftrag <i>Order</i>
29.06.2020	29.06.2020	Bewertung einer Schutzmaske nach Durchführung eines verkürzten Bewertungsverfahrens für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA) gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) Rev. 0 vom 20.03.2020" für das Inverkehrbringen in Österreich <i>Assessment of a protective mask after implementation of a shortened assessment process for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators (CPA) in accordance with enactment GZ 2020-0.247.451 as well as according to "Test principle for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators Rev. 0 dated 20.03.2020" for placing on the market in Austria</i>

### 1.1 Prüfmuster (Samples)

Nr. <i>No.</i>	Eingang <i>Received</i>	Musterbezeichnung <i>Sample Identification</i>
1	29.06.2020	"GIHCCXM01--"

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte Proben.)  
*(Unless otherwise stated samples are provided by the customer.)*

Die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) wurde mit der Nr.: VN635 170861 gekennzeichnet und plombiert. Das Muster wurde dem Antragsteller retourniert und ist Teil des Bewertungsschreibens  
*The Corona Virus Pandemic Respirator (CPA) was marked with the number: VN635 170861. The sample was returned to the applicant and is part of the letter of assessment.*

### 1.2 Eingereichte Unterlagen (Informations given by the Customer)

- Technische Dokumentation (Technical Documentation)
- Verwenderinformation (user information)
- Prüfberichte Nr. (test reports no) T20-1031 (vom dated 26-06-2020)<sup>A)</sup>  
Prüfstelle (test laboratory): Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen  
Physikalisch-technischer Prüfdienst (PTP)

- A) vom Antragsteller zur Verfügung gestellte Prüfberichte wurden als Nachweis zugelassen da sie von einem akkreditierten Prüflabor ausgefertigt und nicht älter als 5 Jahre sind sowie positiv auf Plausibilität und Vollständigkeit überprüft wurden.  
Ausnahme: Im Zuge des weltweiten COVID-19-Ausbruchs werden, entsprechend der Empfehlung der Kommission (EMPFEHLUNG (EU) 2020/403) sowie dem Erlass GZ 2020-0.247.451 über die Durchführung eines verkürzten Bewertungsverfahrens für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA), auch Prüfberichte von geeigneten\*) (nicht akkreditierten) Prüfstellen anerkannt\*\*).

*Test reports provided by the applicant were approved as evidence because they were prepared by an accredited test laboratory and are not older than 5 years and were positively checked for plausibility and completeness.*

*Exception: In the course of the worldwide COVID-19 outbreak, in accordance with the recommendation of the Commission (RECOMMENDATION (EU) 2020/403) and the enactment GZ 2020-0.247.451 on the implementation of a shortened evaluation procedure for Corona SARS-Cov-2 pandemic Respiratory masks (CPA), also test reports from suitable \*) (non-accredited) test laboratories are recognized \*\*).*

- \*) Die Eignung der Prüfstellen wurde durch ein positives Audit festgestellt  
*The suitability of the test laboratory was determined by a positive audit*
- \*\*\*) Für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung bzw. bis zum Ablaufdatum des Erlasses (GZ 2020-0.247.451)  
*For the duration of the current health threat or until the expiry date of the enactment (GZ 2020-0.247.451)*

## 2 **Bewertungsbericht** (*Evaluation report*)

### 2.1 **Allgemein** (*General*)

Die eingereichte Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA)  
*The submitted Corona Virus Pandemic Respirator (CPA)*

#### **"GIHCCXM01--"**

ist ein Atemschutzgeräte (filtrierende Halbmaske) gemäß  
*is a Respiratory protective device (filtering half mask) in accordance with*

Empfehlung (EU) 2020/403

*Recommendation (EU) 2020/403*

PSA-Verordnung (EU) 2016/425

*PPE Regulation (EU) 2016/425*

Konformitätsbewertungs- und Marktüberwachungs-  
verfahren im Kontext der COVID-19- Bedrohung  
*conformity assessment and market surveillance procedures within  
the context of the COVID-19 threat*

Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen  
*Regulation on personal protective equipment*

Bei der Entwicklung der PSA und der technischen Beschreibung wurden folgende Normen und  
Richtlinien beachtet:

*In the development of the PPE and the technical description the following standards and guidelines have been followed:*

- Empfehlung (EU) 2020/403  
*Recommendation (EU) 2020/403*
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425  
*PPE Regulation (EU) 2016/425*

#### **harmonisierte Normen** (*harmonised standards*)

- EN ISO 13688:2013  
*Schutzkleidung, Allgemeine Anforderungen  
Protective clothing – General requirements*
- EN 149:2001+A1:2009  
*Atemschutzgeräte — Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen  
Partikeln — Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung  
Respiratory protective devices — Filtering half masks to protect against particles —  
Requirements, testing, marking*

#### **Nicht harmonisierten Normen / technischen Spezifikationen / Richtlinien** (*non harmonised standards / technical specifications / Guidelines*)

- "Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev. 0 vom 20.03.2020"  
*"Test principle for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators Rev. 0 dated 20.03.2020"*

sowie die jeweils darin herangezogenen Normen.  
*as well as each standard therein relied on.*

#### **Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen**

*Reference to the applied harmonized standards*

- Amtsblatt der Europäischen Union zur "Veröffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der  
harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU" idgF  
*Official Journal of the European Union "Publication of titles and references of harmonised standards under Union  
harmonisation legislation" in the current version*

#### **Fundstellen der angewandten nicht harmonisierten Normen / technischen Spezifikationen / Richtlinien** (*Reference to the applied non-harmonized standards technical specifications and guidelines*)

- GZ 2020-0.247.451  
(vom 23. April 2020)  
*(from April 23rd, 2020)*  
Erlass der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort  
über die Durchführung eines verkürzten Bewertungsverfahrens für  
Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA)  
*enactment of the Federal Ministry for Digital and Economic Affairs on the  
Implementation of a shortened assessment process for Corona SARS-Cov-2  
pandemic respirators (CPA)"*

## 2.2 Anforderungen (Requirements)

### 2.2.1 Anforderungen an die technischen Unterlagen (Requirements for the technical documentation)

Prüfungen (tests)	Anforderung (requirement)	Resultat (result)
Überprüfung der technischen Unterlagen (Examination of the technical documentation) *) Anhang III Buchstabe j) wird entsprechend der Verordnung 2016/425 Anhang V Pkt.4 a) nicht beachtet. (According the Regulation 2016/425 (EU) Annex III, point j) was not taken into account)	Verordnung (EU) 2016/425 Anhang III Regulation (EU) 2016/425 Annex III	nicht erfüllt (not fulfilled) *)
Überprüfung der technischen Unterlagen gemäß dem Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (Rev. 0 vom 20.03.2020) Review of the technical documentation in accordance with the test principle for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators (Rev. 0 from 20.03.2020)	Pkt. 2.7 Kennzeichnung und Informationen des Herstellers pt. 2.7 Manufacturer identification and information	erfüllt (fulfilled)
<p><b>Beurteilung:</b> Aufgrund der Erfüllung der Anforderungen des verkürzten Bewertungsverfahrens für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung als erfüllt bewertet.</p> <p><b>Assessment:</b> Based on the fulfillment of the requirements of the shortened assessment procedure, assessed as fulfilled for the duration of the current health threat.</p>		

### 2.2.2 Designanforderungen und Ausführung der PSA (Design requirements and Construction of the PPE)

Prüfungen (tests)	Anforderung (requirement)	Resultat (result)
Grundsätzliche Anforderungen hinsichtlich Ergonomie – EN ISO 13688 (Basic ergonomic requirements EN ISO 13688)	EN ISO 13688 Pt.4.3 / 4.4	erfüllt (fulfilled)
Prüfgrundsatz "Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev. 0 vom 20.03.2020" test principle for "Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators (Rev. 0 from 20.03.2020)"		erfüllt (fulfilled)

### 2.2.3 Anforderungen an die Materialien der PSA (Material requirements for PPE)


#### Anforderungen an die Maske gemäß "Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken Rev. 0 vom 20.03.2020" verkürzten Bewertungsverfahrens in Anlehnung an EN 149:2001+A1:2009

Requirements for the mask according to the "Test principle for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirator masks Rev. 0 from 20.03.2020" shortened assessment process based on EN 149:2001 + A1:2009

Prüfungen (tests)	Einheit (unit)	Anforderung (requirement)	Resultat (result)
Erläuterung (note): nz ... nicht zutreffend (not applicable)			
Sichtprüfung (Visual inspection) EN 149 Pkt. (pt.) 8.2			erfüllt (fulfilled)
Anlegeprüfung (Application test) EN 149 Pkt. (pt.) 8.4.1 *) subjektive Bewertung durch Geräteträger (Testperson) (subjective assessment by a test person) **) Die Passform der Maske ist abhängig von der Gesichtsform des Trägers, daher ist vor der Verwendung eine Passformkontrolle durchzuführen (The fit of the mask depends on the face shape of the wearer, so a fit check must be carried out before use)			erfüllt (fulfilled) *) **)
Atemwiderstand – Geräte ohne Ventil (Breathing Resistance - Devices without a valve) EN 149 Pkt. (pt.) 7.16 & 8.9.2 & 8.9.3 Ausatmung (exhalation) EN 149 Pkt. (pt.) 8.9.2			
Messung (Measurement) 1	mbar	≤ 3,0	1,3
Messung (Measurement) 2	mbar	≤ 3,0	1,4

Einatmung (inhalation) EN 149 Pkt. (pt.) 8.9.3			
Messung (Measurement) 1	mbar	≤ 3,0	0,7
Messung (Measurement) 2	mbar	≤ 3,0	0,7
Atemwiderstand – Geräte mit Ventil (Breathing Resistance - Devices with a valve) EN 149 Pkt. (pt.) 7.16 & 8.9.2 & 8.9.3			nz
Ausatemventil - Durchströmung (Exhalation valve flow) EN 149 Pkt. (pt.) 7.15 & 8.3.4			nz
Durchlass des Filtermediums mit 95 l/min, nach Temperaturkonditionierung bei hoher Temperatur und Gebrauchssimulation mit feuchter Beatmung für 20 min (Penetration of filter material with 95 l/min, after temperature conditioning at high temperature and use simulation with moist ventilation for 20 minutes) EN 149 Pkt. (pt.) 7.9.2 & 8.11			
Natriumchloridprüfung (Sodium chloride test)			
Messung (Measurement) 1	%	≤ 6,0	1
Messung (Measurement) 2	%	≤ 6,0	3
Messung (Measurement) 3	%	≤ 6,0	4
<u>Beurteilung nach Durchführung eines verkürzten Bewertungsverfahrens für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA) gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) Rev. 0 vom 20.03.2020" für das Inverkehrbringen in Österreich</u> <i>Assessment after performing of a shortened assessment process for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators (CPA) in accordance with enactment GZ 2020-0.247.451 as well as according to "Test principle for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators Rev. 0 dated 20.03.2020" for placing on the market in Austria</i>			bestanden (passed)

### 3 Fotodokumentation (photo documentation)

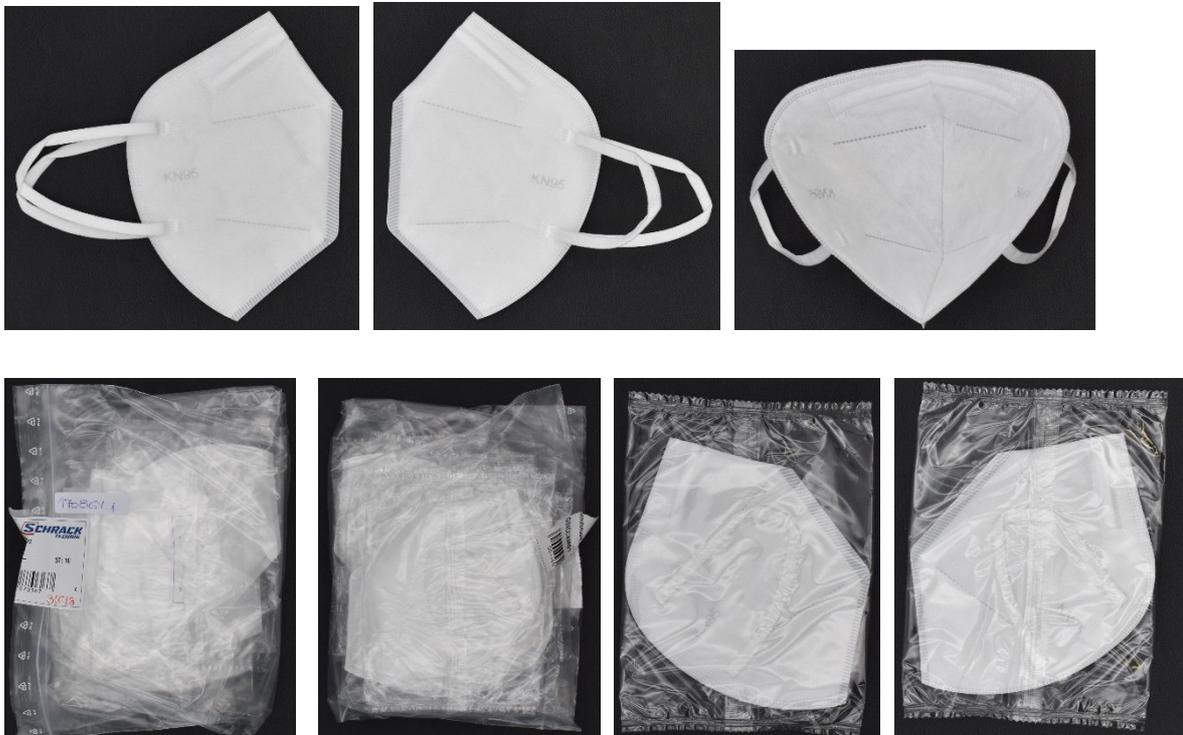

Fotos aus Prüfberichte Nr. (Photos from test reports no) T20-1031

Prüfstelle (test laboratory): Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; Physikalisch-technischer Prüfdienst (PTP)



#### 4 Bewertung (assessment)

Aufgrund der eingereichten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungen wird bescheinigt, dass die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)

*Based on the documents submitted and the and the examinations carried out this is to certify, that the Corona Virus Pandemic Respirator (CPA)*

#### "GIHCCXM01--"

des Antragstellers (Inverkehrbringer)  
*of the applicant (distributor)*

Schrack Technik GmbH  
Seybelgasse 13  
1230 Wien  
Austria

Hersteller  
*(manufacturer)*

Jiangsu Sanfo outdoor products Co.,Ltd  
Room 201, Building3, e-Commerce Logistic Park,  
Hongzehu East Road, Suyu Distrikt, Suquian City,  
Jiangsu Province, China 223800

den Anforderungen des verkürzten Bewertungsverfahrens gemäß Erlass GZ 2020-0.247.451 sowie gemäß "Prüfgrundsatz\*" für Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) Rev. 0 vom 20.03.2020" für das Inverkehrbringen in Österreich in Anlehnung an EN 149:2001+A1:2009 entspricht, somit kann folgendes festgestellt werden:

*corresponds to the requirements of the shortened assessment process for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators (CPA) in accordance with enactment GZ 2020-0.247.451 as well as according to "Test principle\*" for Corona SARS-Cov-2 pandemic respirators Rev. 0 dated 20.03.2020" for placing on the market in Austria based on EN 149: 2001 + A1: 2009, so the following can be stated*

**Die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmaske (CPA) hat die durchgeführte Prüfung mit positivem Ergebnis bestanden** <sup>Anm.)</sup>

*The Corona Virus Pandemic Respirator (CPA) passed the test with a positive result <sup>note)</sup>.*

Die PSA wird zugeordnet der PSA-Kategorie III

*This PPE will be assigned to category III*

\*) nicht harmonisierte Norm (non-harmonized standard)

Anm.) Die Passform der Maske ist abhängig von der Gesichtsförm des Trägers, daher ist vor der Verwendung eine Passformkontrolle durchzuführen. Hierzu muss der Maske eine entsprechende Information beigelegt werden.

note) *The fit of the mask depends on the face shape of the wearer, so a fit check must be carried out before use. Appropriate information must be enclosed with the mask.*

## 5 Gültigkeit (validity)

Dieses Bewertungsschreiben gilt ausschließlich für die Verwendung der zuvor genannten Masken für medizinischen Fachkräften für die Dauer der derzeitigen Gesundheitsbedrohung und/oder bis zum Außerkrafttreten des Erlass GZ 2020-0.247.451. Falls nach dem Ablauf des Erlasses GZ 2020-0.247.451 die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) auch weiterhin in Verkehr gebracht werden soll, dann ist die Durchführung einer vollständigen EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) erforderlich

*This letter of assessment applies only to the use of the masks mentioned above to medical professionals for the duration of the current health threat and / or until the GZ 2020-0.247.451 decree expires. If after the expiry of the decree GZ 2020-0.247.451 the corona virus pandemic respirator (CPA) should continue to be placed on the market, then a complete EU type examination certificate (module B) is required*

### Wichtige Hinweise (important notes):

- **Eine CE-Kennzeichnung der Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) ist nicht zulässig**  
*A CE marking of the Corona Virus Pandemic Respirators (CPA) is not permitted*
- **Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) die auf Basis der Empfehlung (EU) 2020/403 der Kommission vom 13. März 2020 und Erlasses 2020-0.247.451 (vom 23. April 2020) ohne CE-Kennzeichnung auf dem Österreich in Verkehr gebracht werden, dürfen nur für medizinische Fachkräfte bereitgestellt werden**  
*Corona virus pandemic respirators (CPA) based on Commission Recommendation (EU) 2020/403 of March 13, 2020 and enactment 2020-0.247.451 (of April 23rd, 2020) without CE marking placed on the market in Austria may only be made available to medical professionals*
- **Die nach dem verkürzten Verfahren bewertete Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) sind keine persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA Verordnung (EU) 2016/425.**  
*The corona virus pandemic respirators (CPA) assessed according to the shortened assessment process are not personal protective equipment according to PSA regulation (EU) 2016/425.*
- **Die Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA) sind nicht als gleichwertig mit Atemschutzgeräten anzusehen, die eine vollständige Prüfung nach EN 149:2001+A1:2009 bestehen und auf Basis der PSA VO (EU) 2016/425 mit einer EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) zugelassen wurden.**  
*The Corona Virus pandemic respirators (CPA) are not considered equivalent to respirators that have passed a full test according to EN 149: 2001 + A1: 2009 and are based on the PSA VO (EU) 2016/425 with an EU type examination certificate (Module B) have been approved.*

## 6 Anmerkungen (Remarks)

### Muster

Die Bescheinigung gilt für das eingereichte Baumuster unter Einbeziehung der eingereichten technischen Dokumentation und Prüfberichte. Die Gültigkeit der vorgelegten Prüfberichte für die eingesetzten Materialien liegt in der Verantwortung des Auftraggebers.

### Sample Material

*The Type examination report is valid for the provided type sample in conjunction with the provided technical documentation and the test reports. The validity and appropriateness of the test reports for the used materials is the sole responsibility of the applicant.*

### Ausfertigung

Die gültige Erstaussfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Übersetzungen werden am Deckblatt als solche gekennzeichnet.

### Issuance

*The valid first issue is done in paper and has single-handed signatures. Translations will be marked accordingly on the cover sheet.*

### Qualitätsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung

Alle Leistungen unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065. Das OETI ist akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB 0534). (<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>). Die Akkreditierung erfolgte durch die nationale Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria. Der Akkreditierungsumfang ist auf [www.oeti.biz](http://www.oeti.biz) zu ersehen. Das Akkreditierungszeichen darf gemäß Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschließlich von der akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle verwendet werden. Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) muss die Verwendung gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/425 erfolgen. Bei Bauprodukten ist die Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklärung zulässig.

### Quality management, Accreditation and Notification

*All tests and services are performed under a quality management system according to EN ISO/IEC 17025 respectively EN ISO/IEC 17065. OETI is accredited as Testing Laboratory and Certification Body for products. It also is a Notified Body with the registration number 0534 (see <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>). Accreditation was provided by Akkreditierung Austria. The scope of accreditation is listed on [www.oeti.biz](http://www.oeti.biz). According to the decree on the use of the accreditation mark ("AkkZV") the accredited Conformity Assessment Body is the only one to use the accreditation mark. Application of the registration number of the Notified Body: As to personal protective equipment (PPE) the requirements of Regulation (EU) 2016/425 have to be kept. With construction products the application is only permitted within the declaration of performance for CE-marking.*

### Gültigkeit Baumusterprüfbescheinigung

Die Gültigkeit von Baumusterprüfbescheinigungen ist generell auf maximal 5 Jahre begrenzt. Wird vor Ablauf der 5-jährigen Geltungsdauer eine Änderung einer Bezugsnorm vorgenommen, bleibt die Gültigkeit unverändert bestehen, ausgenommen die Änderung erfolgte aus Sicherheitsgründen. In diesem Fall endet die Gültigkeit mit dem Rückzug der Norm. Eine Verlängerung der Gültigkeit kann beantragt werden, wenn alle Bezugsnormen weiterhin gültig sind und keine Änderungen vorgenommen wurden. Der Antrag um Verlängerung kann frühestens 12 Monate bzw. muss spätestens 6 Monate vor Ablauf Gültigkeit gestellt werden.

Diese Bescheinigung darf bei PSA der Kategorie III nur in Verbindung mit einem der Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Verordnung (EU) 2016/425 Artikel 19 Buchstabe c) verwendet werden.

### Validity type-examination certificate

*The validity of the type-examination certificate is generally limited to a maximum of 5 years. If a reference standard will be modified before the 5-year period of validity is expired, the validity remains unchanged, except if the change was made for safety reasons. In this case, the validity ends with the withdrawal of the standard. If all reference standards remain valid and no changes were made on the prototype, an extension of validity can be done. An application for extension of the validity may be placed at the earliest 12 months and no later than 6 months before the expiry of validity.*

*This certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to in point (c) of Regulation (EU) 2016/425 Article 19.*

### Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche – vom Reportersteller nicht autorisierte – Veränderungen, Ergänzungen oder Verfälschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlägigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches. Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Veröffentlichungen - auch auszugsweise - und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung des ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH. Reports dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nur in voller Länge reproduziert werden.

### Copyright and Usage Notes

*It is pointed out, that any alterations, amendments or falsifications of reports not authorized by the issuer of the report will be prosecuted as civil and criminal offences; this especially to the appropriate requirements of ABGB, UrhG, UWG and criminal law and their respective international equivalents.*

*Reports are protected under international copyright laws. Written consent of the ÖTI is required for publications (also in excerpt) and reference to tests for public relation purposes. Reports may only be reproduced in full length.*

Reportende (End of report)